Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
DRÄGERWERK AG Lübeck

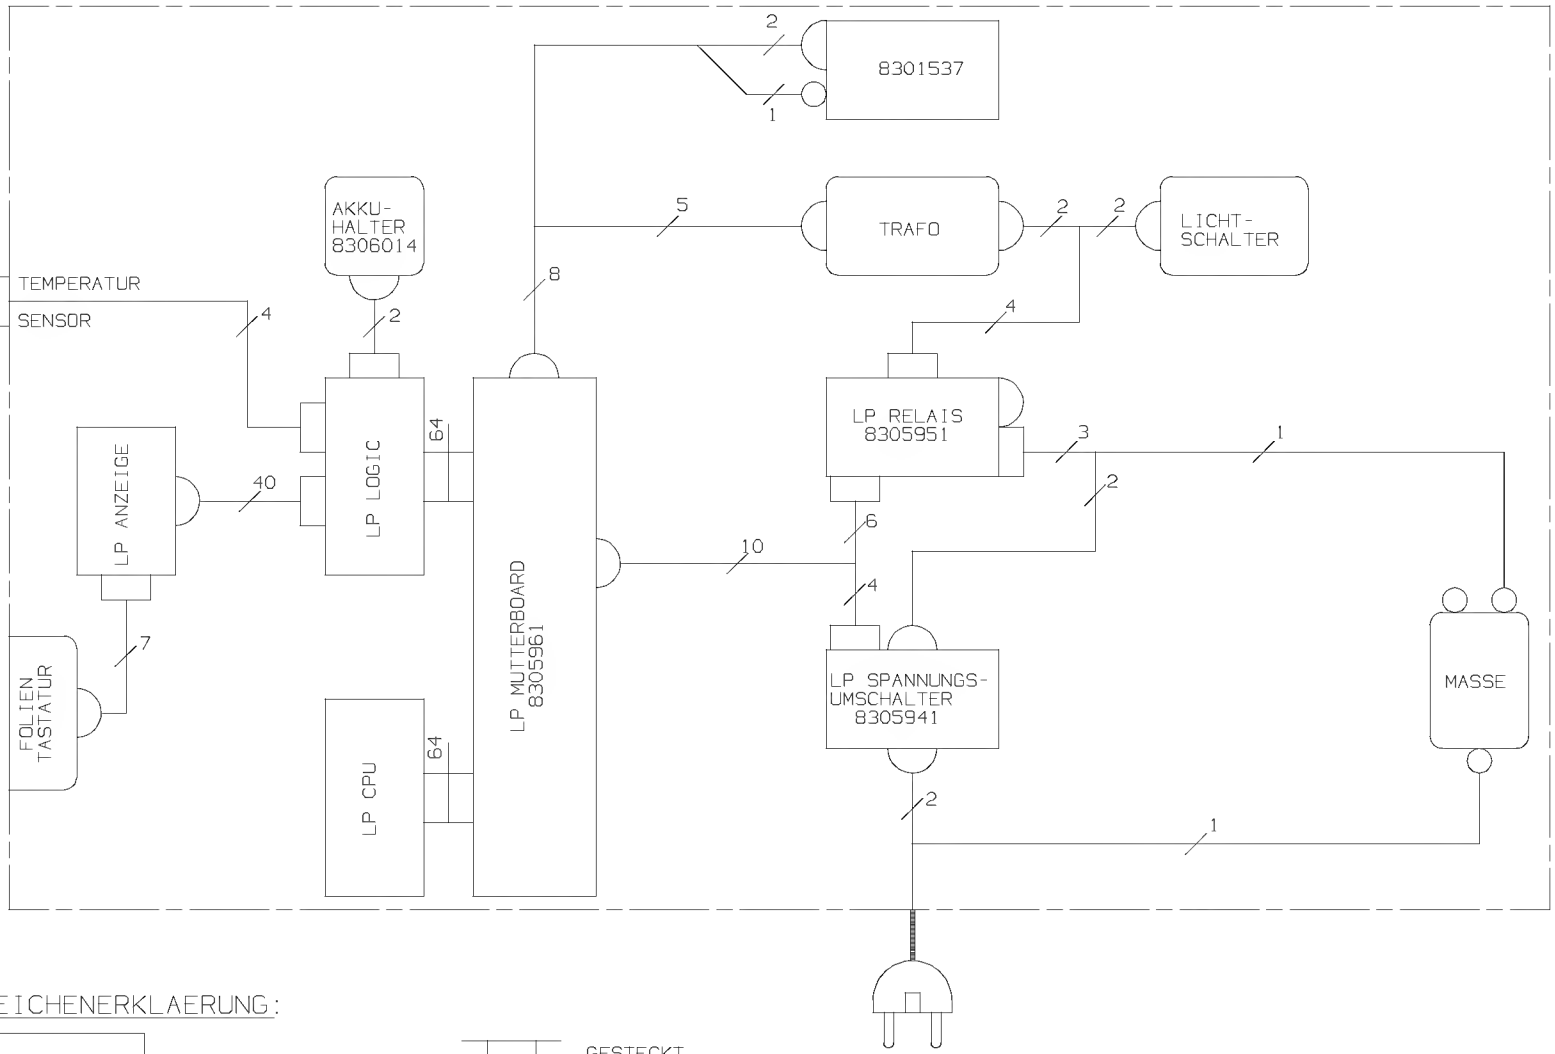

ZEICHENERKLAERUNG:

- LEITERPLATTE
- ANDERE ELEKTR. EINHEIT
- 20 ADERZAHL
- GESTECKT
- DIREKT ANGESCHLOSSEN
- LSP AUF LOETSTUETZPUNKT GELOETET
- GESCHRAUBT

=0A=	- -	=0B=	- -	=0C=	- -		
Werkstoff							

				0	- -		
				Aend Ziffer	kommt vor	(114/90) Aenderungen	
Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung		1990	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
---	---	RM		Bearb	05.02.	GRUBE	
				Gepr.		SEI	
		Benennung				Zeichnungs-Nr.	
		VERBINDUNGSSCHEMA				8305928	
						Ersatz fuer	
INFO	CADRA					Ersetzt durch	

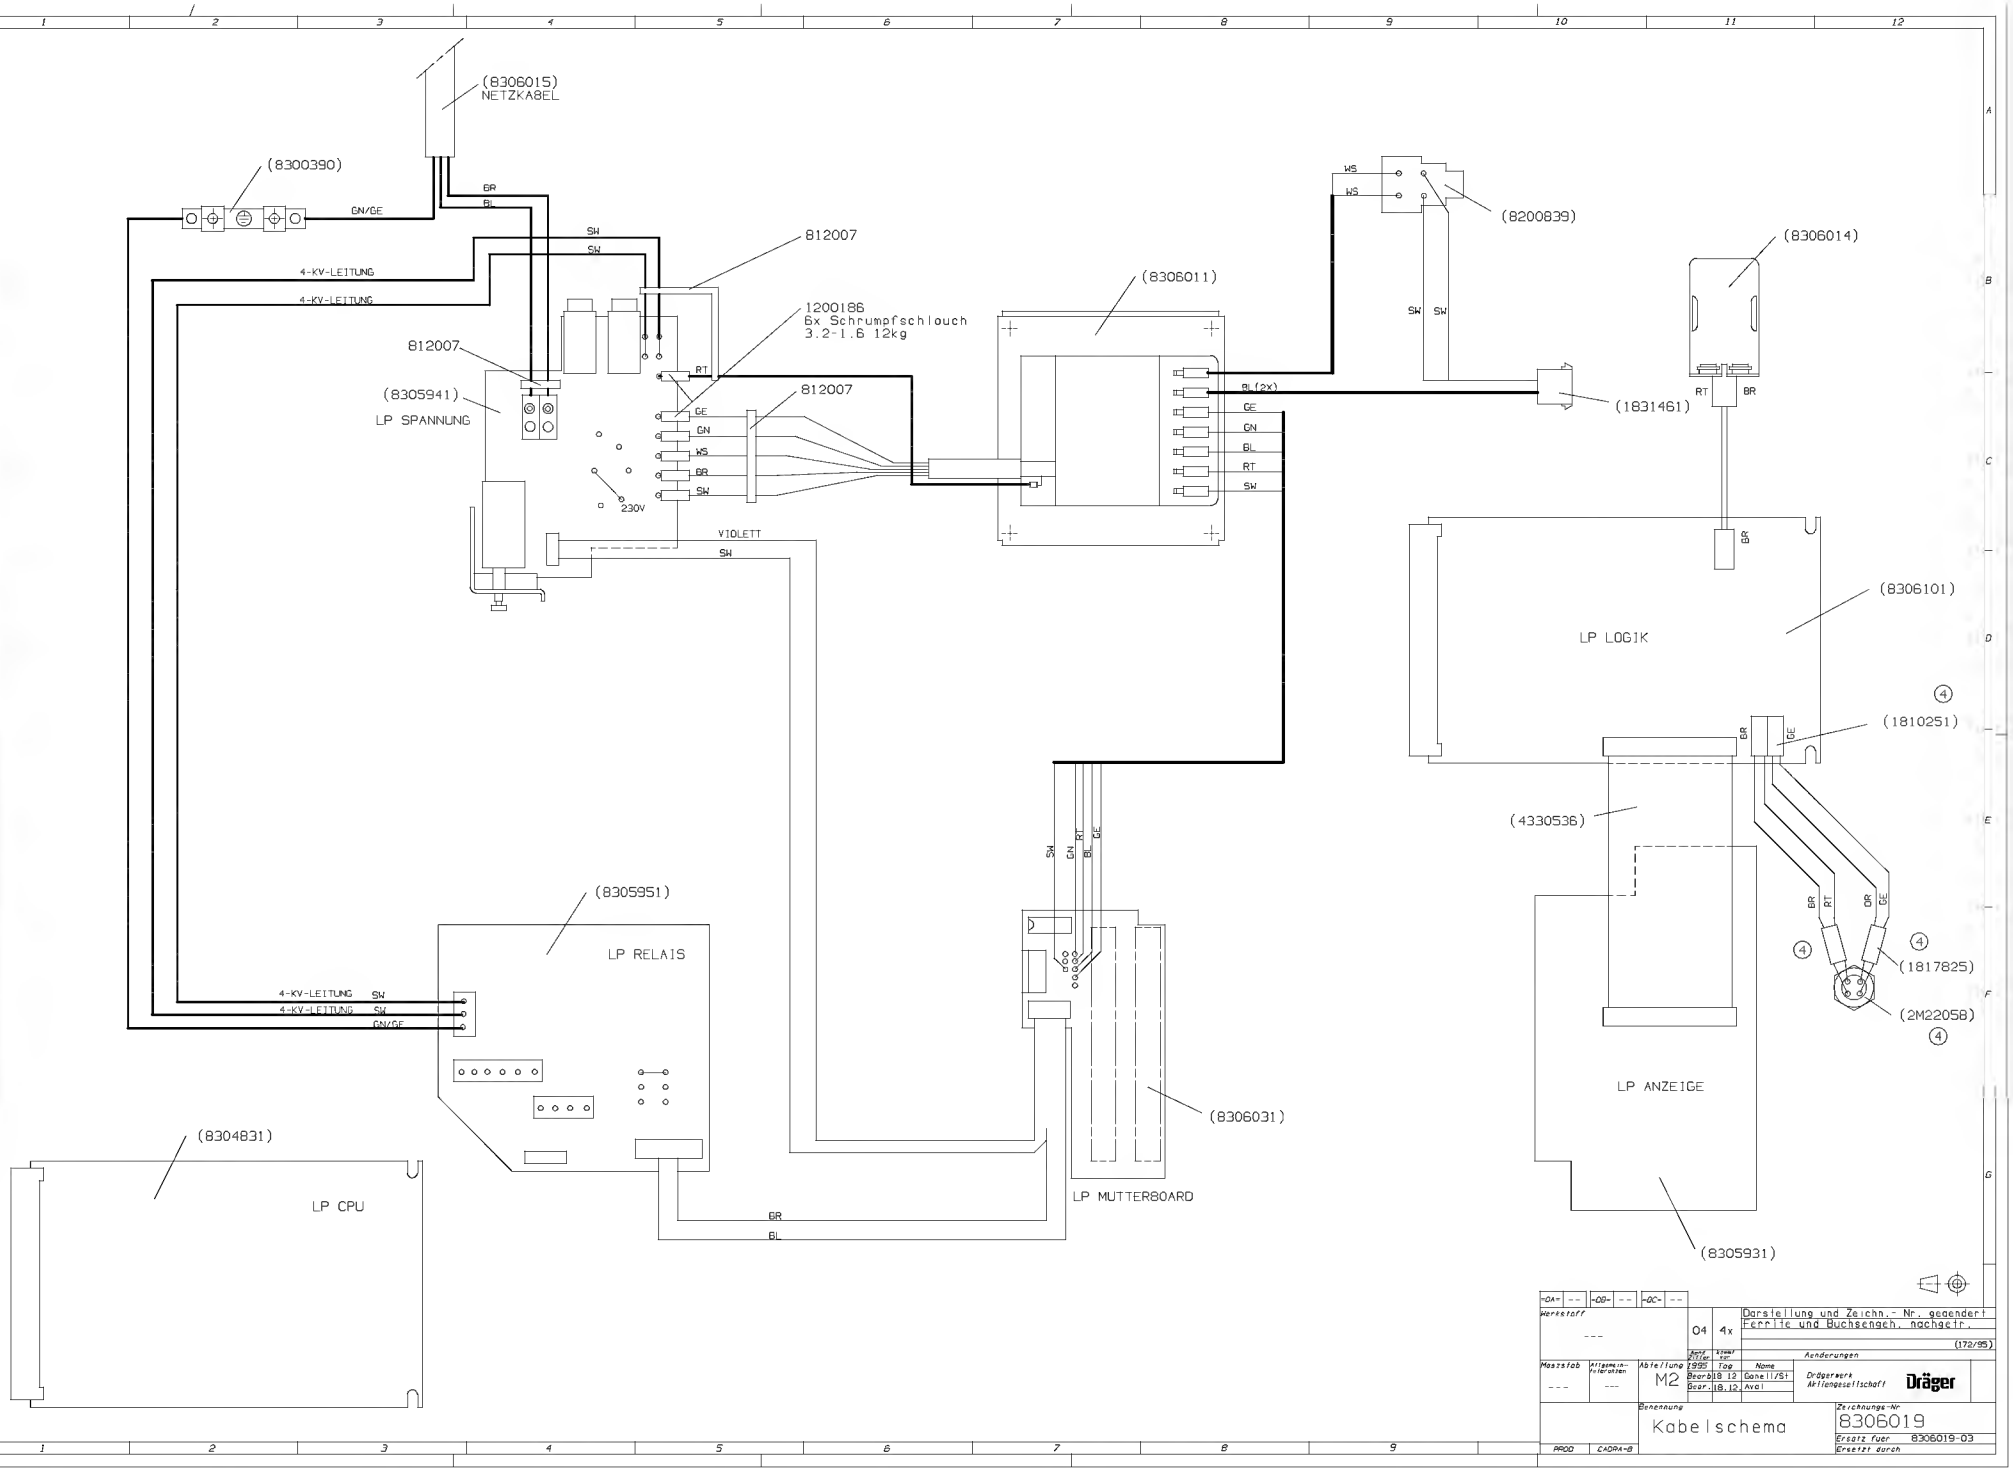
(8306015)
NETZKABEL
(8300390)
GN/GE
BR
BL
SW
SW
4-KV-LEITUNG
4-KV-LEITUNG
812007
1200186
6x Schrumpfschlauch
3.2-1.6 12kg
812007
812007
(8305941)
LP SPANNUNG
RT
GE
GN
WS
BR
SW
230V
VIOLETT
SW
(8306011)
BL(2x)
GE
GN
BL
RT
SW
WS
WS
(8200839)
SW
SW
(1831461)
(8306014)
RT
BR
BR
(8306101)
LP LOGIK
(1810251)
BR
GE
(4330536)
(1817825)
(2M22058)
LP ANZEIGE
(8305931)
SW
GN
RT
BL
GE
(8305951)
LP RELAIS
4-KV-LEITUNG SW
4-KV-LEITUNG SW
GN/GE
(8306031)
LP MUTTERBOARD
BR
BL
(8304831)
LP CPU
-0A- -- -0B- -- -0C- --
Werkstoff

04
4x
Darstellung und Zeichn.- Nr. geaendert
Ferrite und Buchsengeh. nachgetr.
(172/95)
Aenderungen
Maßstab

Allgemein-toleranzen

Abteilung
M2
Zeichner
Datum
1995
Bearb
18.12
Gepr.
18.12.
Name
Tag
Gonell/St
Avci
Drägerwerk Aktiengesellschaft
Dräger
Benennung
Kabelschema
Zeichnungs-Nr
8306019
Ersatz fuer 8306019-03
Ersetzt durch
PROD
CADPA-B

(8306015)
NETZKABEL

(8300390)

GN/GE

BR
BL

SW
SW

4-KV-LEITUNG

4-KV-LEITUNG

(8305941)
LP SPANNUNG

RT

GE
GN
WS
BR
SW

230V

VIOLETT
SW

(8306011)

(8200839)

WS
WS

SW SW

(8306014)

RT EP

BR

(8306101)

LP LOGIK

BR GE

(4330536)

(8305929)

LP ANZEIGE

(8305931)

(8305951)

LP PELAIS

4-KV-LEITUNG SW
4-KV-LEITUNG SW
GN/GE

(8306031)

LP MUTTERBOARD

(8304831)

LP CPU

| | | |